


Brussel, 19 november 2013

Geachte dokter,

Deze brief wordt u overhandigd door de behandelende specialist van uw patiënt teneinde de injectie van Depo-Eligard[®] zo goed mogelijk voor te bereiden en toe te dienen. Hierbij vindt U de gedetailleerde gebruiksaanwijzing van Depo-Eligard[®]. Wij willen vooral uw aandacht vestigen op stap nr 3.

Stap nr 3:

Verwijder de **blauwe stop** door te **TREKKEN**, niet draaien, want de **grijze rubber** die eraan vast zit moet **mee verwijderd** worden. Dit is het belangrijkste voor een geslaagde inspuiting!

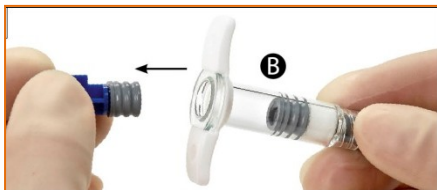

Enkel de 6 maanden formulering heeft een vrij lange injectiespuit. Daarom is het hier nog belangrijker dan bij de andere formuleringen om de eerste blauw/grijze stop in zijn geheel te verwijderen (stap nr 3). Dit is van belang om te vermijden dat er teveel lucht in de bereiding terechtkomt.

DEPO-ELIGARD[®] is verkrijgbaar in 3 doseringen voor 1 maand (7,5 mg), 3 maanden (22,5mg) en 6 maanden (45 mg) en is een “goedkoop geneesmiddel (☺)”.

Indien u toch een demonstratie wenst of nog bijkomende vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met mij via email: marie.hubin@astellas.com. Ik zal uw vraag bezorgen aan de betrokken Hospitaal Vertegenwoordiger, die dan aansluitend met u contact opneemt.

Hoogachtend,

Marie Hubin
Hospital Team Marketing Assistant
Astellas Pharma BV


DEPO-ELIGARD® - Gebruiksaanwijzing

Het is belangrijk om uw patiënt te laten liggen met de buik vrijgemaakt vòòrleer u aan de bereiding begint. Het geneesmiddel dient na bereiding **onmiddellijk subcutaan** (t.h.v. het abdomen) geïnjecteerd te worden.


De bereiding dient op kamertemperatuur te gebeuren. De verpakking wordt dus best 20-30 minuten vòòr de bereiding uit de koelkast gehaald.

U gaat als volgt te werk:


1. Open beide verpakkingen en leg alle onderdelen naast elkaar.
2. Er zijn twee spuiten : de injectiespuit B (met de vleugeltjes en de dubbele blauw/grijze afsluitdop), en de mengspuit A.
3. Verwijder de **blauwe stop** door te **TREKKEN**, niet draaien, want de **grijze rubber** die eraan vast zit moet **mee verwijderd** worden. Dit is het belangrijkste voor een geslaagde inspuiting!

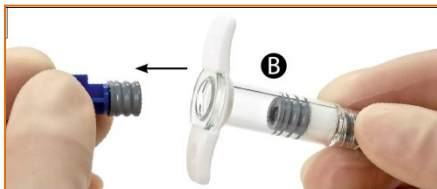


4. Duw de witte zuiger in de injectiespuit en **DRAAI** hem vast op de grijze rubber net boven het poeder.

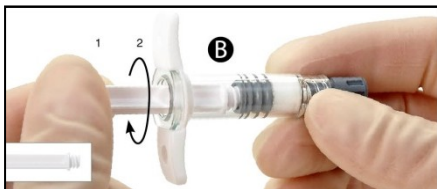


5. Verwijder het donkergrijze rubberen afsluitdopje aan de voorkant van de injectiespuit B door goed te trekken.
6. Verwijder het plasticen afsluitdopje op de mengspuit A, door te draaien.
7. Schroef vervolgens de twee spuiten op elkaar en duw de zuigers **vlot** heen en weer tot de vloeistof en het poeder homogeen gemengd zijn. (30X heen en weer is voldoende voor alle doseringen).

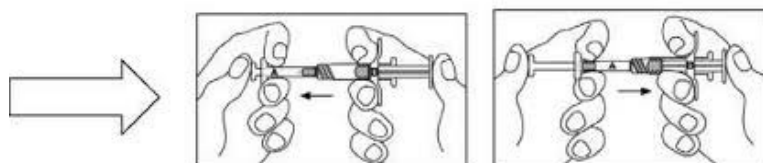

- Hou alles vertikaal (injectiespuit B onderaan) terwijl u de vloeistof volledig in de injectiespuit duwt. Trek de witte zuiger wat naar achter om geen vloeistof te verliezen terwijl u de 2 spuitten los van elkaar draait.

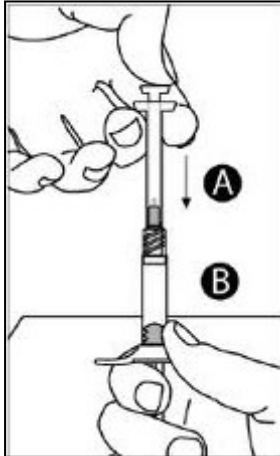

- Schroef de bijgeleverde naald op de injectiespuit en verwijder de eventuele overtollige lucht.

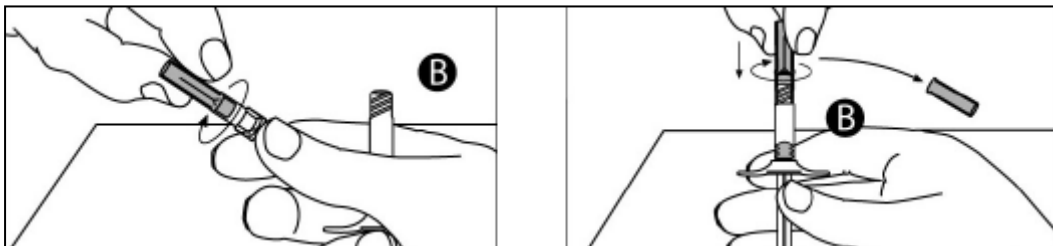

- Injecteer **onmiddellijk subcutaan** t.h.v. het abdomen. Niet wrijven op de injectieplaats om de gel de kans te geven een bolletje (implantaatje) te vormen.